

Inhalt

1	Einführung.....	3
1.1	Was ist das Vivo 30?.....	4
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.3	Kontraindikationen	5
1.4	Zu dieser Gebrauchsanweisung	6
2	Sicherheitshinweise	7
2.1	Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	7
2.2	Elektrische Sicherheit	9
2.3	Umgebungsbedingungen	10
2.4	Verwendung des Patientenschlauchsystems	11
2.5	Verwendung von Filtern	12
2.6	Luftbefeuchtung	13
2.7	Reinigung und Wartung	14
2.8	Nebenwirkungen	14
2.9	Verwendung von Sauerstoff	15
3	Produktbeschreibung	16
3.1	Hauptkomponenten.....	16
3.2	Zubehör	18
3.3	Das Vivo 30-Bedienfeld	19
3.4	Die Rück- und Seitenteile des Vivo 30	20
3.5	Typenschild und Sicherheitssymbole	21
4	Funktionen und Parameter des Vivo 30.....	23
4.1	Beatmungsmodus	23
4.2	Einstellungen.....	23
4.3	Standby- und Betriebsmodus	23
4.4	Erkennung Leckage Tief	24
4.5	Luftbefeuchter (optional)	24
5	Verwendung des Vivo 30	25
5.1	Überprüfung des Vivo 30 vor der Inbetriebnahme	25
5.2	Ein- und Ausschalten des Vivo 30	26
5.3	Arbeiten mit dem Menü	27
5.4	Überwachungsbereich	30
5.5	Verwendung des Luftbefeuchters HA 20	31
5.6	Verwendung der Batterien.....	32
5.7	Vivo 30 Betriebszeit	33
6	Vorbereitung des Vivo 30	34
6.1	Installation des Vivo 30	34
6.2	Aufstellen des Vivo 30	35
6.3	Anschluss des Vivo 30 an das Stromnetz	35
6.4	Anschluss des Patientenschlauchsystems	36
7	Alarmer	37
7.1	Alarmfunktion	37
7.2	Physiologischer Alarm.....	39
7.3	Technischer Alarm.....	44

8	Reinigung des Vivo 30 und Austausch des Zubehörs	47
8.1	Reinigung des Vivo 30	47
8.2	Reinigung und Austausch der Patienten-Luftfilter	49
8.3	Patientenwechsel	51
9	Wartung.....	52
9.1	Regelmäßige Wartungsarbeiten	52
9.2	Service und Reparatur	53
9.3	Aufbewahrung	53
9.4	Entsorgung.....	53
10	Technische Daten	54
10.1	Daten	54
11	Zubehör.....	59
11.1	Breas-Zubehörliste.....	59
12	Patienteneinstellungen.....	61

1 Einführung



WARNUNG!

Das Vivo 30 darf nur verwendet werden:

- für die Behandlung gemäß der Gebrauchsanweisung und den Anweisungen des zuständigen Klinikpersonals;
- gemäß den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Betriebsbedingungen;
- in seiner ursprünglichen, unveränderten Form und nur mit von Breas Medical AB zugelassenem Zubehör.

Jede andere Anwendung kann zu körperlichen Schäden führen!



VORSICHT!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Vivo 30 verwenden, damit Sie genau wissen, wie es bedient und gewartet wird, um eine korrekte Anwendung und eine maximale Leistung und Lebensdauer garantieren zu können.



WARNUNG!

Verwenden Sie das Vivo 30 nicht für lebenserhaltende Maßnahmen.



Breas Medical AB behält sich das Recht vor, dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

1.1 Was ist das Vivo 30?

Das Vivo 30 ist ein druckunterstütztes, druckkontrolliertes Beatmungsgerät.

Es hat drei Beatmungsmodi: PCV (Pressure Control Ventilation), PSV (Pressure Support Ventilation) und CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Die PCV- und PSV-Modi bieten die Möglichkeit, die Inspirationstrigger-Empfindlichkeit einzustellen, wodurch der Patient vom Beatmungsgerät unterstützte Atemzüge initiieren kann.

- Im PCV-Modus (Pressure Control Ventilation) sorgt das Beatmungsgerät für eine assistierte oder kontrollierte, druckkontrollierte Beatmung. Im PCV-Modus wird vom Klinikpersonal eine Inspirationszeit eingestellt. Der inspiratorische Druck wird über den IPAP-Wert (Inspiratory Positive Airway Pressure) eingestellt. Der endexpiratorische Druck wird über den EPAP-Wert (Expiratory Positive Airway Pressure) eingestellt.
- Im PSV-Modus (Pressure Support Ventilation) kann der Expirationstrigger des Beatmungsgeräts auch eingestellt werden, um dieses einfacher an die Bedürfnisse des Patienten anzupassen. Der inspiratorische Druck wird über den IPAP-Wert eingestellt. Der endexpiratorische Druck wird über den EPAP-Wert eingestellt.
- Im CPAP-Modus (Continuous Positive Airway Pressure) sorgt das Beatmungsgerät für einen kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck.

Das Vivo 30 hat einen Drucksensor, der kontinuierlich den Ausgangsdruck mit dem Umgebungsdruck vergleicht, um automatisch Höhenunterschiede zu kompensieren.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Vivo 30 ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen oder für den Transport von Notfallpatienten geeignet.

Das Vivo 30 darf nur bei Patienten mit ausreichend spontaner Atmung verwendet werden.

Das Vivo 30 wurde für Patienten entwickelt, die bis zu maximal 20 Stunden pro Tag, nachts und teilweise tagsüber Unterstützung durch mechanische Beatmung benötigen.

Das Vivo 30 ist für die nicht-invasive Anwendung vorgesehen.

Das Vivo 30 ist für die Verwendung in klinischen Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Schlaflabors, Pflegeeinrichtungen) und zu Hause vorgesehen. Das Vivo 30 muss immer von einem Arzt verschrieben werden.

Das Vivo 30 ist ausschließlich für die Behandlung von Erwachsenen vorgesehen.

Das Vivo 30 darf nur von qualifiziertem und dafür geschultem Personal bedient werden oder von Personen, die anhand der Gebrauchsanweisung (Klinik) in die Bedienung eingewiesen wurden.

1.3 Kontraindikationen

Der Einsatz des Vivo 30 ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer respiratorischer Insuffizienz ohne einen spontanen Atemantrieb.

Eine Therapie mit dem Vivo 30 darf bei nachfolgend spezifizierten Kontraindikationen nicht verschrieben werden:

- Pathologisch niedriger Blutdruck
- Schwere Herzrhythmusstörungen
- Instabile Angina pectoris
- Dekompensierte Herzinsuffizienz, Hypotension, besonders in Verbindung mit intravaskulärem Volumenmangel
- Unbehandelter Pneumothorax
- Pneumomediastinum
- Starkes Nasenbluten oder früheres starkes Nasenbluten (Gefahr des Wiederauftretens)
- Pneumocephalus, kürzlich erlittenes Trauma oder Operation, die eine Cranio-nasopharyngeal-Fistel hervorgerufen hat

Vorsicht ist bei der Verordnung einer CPAP-Therapie bei Patienten mit z. B. Abnormitäten der Siebplatte, älteren Schädeltraumata oder Pneumocephalus angebracht.

Eine zeitweilige Kontraindikation zur CPAP-Therapie kann auch bei Anzeichen einer Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündung des Patienten vorliegen.

1.4 Zu dieser Gebrauchsanweisung



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Vivo 30 installieren und verwenden oder Wartungsarbeiten am Gerät ausführen, denn nur bei vorschriftsmäßiger Bedienung können maximale Leistung und Lebensdauer garantiert werden.



Breas Medical AB behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zielgruppe

Diese Gebrauchsanweisung ist für Patienten und andere Nicht-Fachleute gedacht, die das Vivo 30 verwenden.



Pflege- und Klinikpersonal sowie Ärzte und andere, die sich im Umgang mit dem Vivo 30 auskennen müssen, erhalten weitere Einzelheiten zu Einstellungen und Funktionen in der Gebrauchsanweisung (Klinik).

Verwendete Symbole

In dieser Gebrauchsanweisung werden Symbole verwendet, um Sie auf besondere Informationen aufmerksam zu machen. Die Bedeutung dieser Symbole ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

SYMBOL	ERLÄUTERUNG
	Warnung! Tödliche Gefahr und Gefahr von schweren körperlichen Verletzungen.
	Vorsicht! Gefahr von geringen oder mäßigen körperlichen Verletzungen. Gefahr von Sachschäden, Datenverlust, zusätzlicher Arbeit oder unerwünschten Ergebnissen.
	Hinweis Informationen, die zwar nicht von erheblicher Bedeutung sind, aber dennoch wertvoll sein können, Tipps.
	Verweis Verweis auf andere Gebrauchsanweisungen, in denen Sie zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Thema finden können.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen



- Das Vivo 30 muss mindestens einmal täglich aus- und eingeschaltet werden. Dies ist notwendig, damit das Vivo 30 einen Selbsttest ausführen kann.
- Das Vivo 30 darf nicht bei lebenserhaltenden Maßnahmen eingesetzt werden.
- Das Vivo 30 darf nur bei Patienten mit ausreichend spontaner Atmung verwendet werden.
- Wenn Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden oder eine andere Form der medizinischen Behandlung verordnet bekommen, informieren Sie das medizinische Personal stets über Ihre mechanische Beatmungsbehandlung.
- Vivo 30 darf nur verwendet werden:
 - für die Behandlung gemäß der Gebrauchsanweisung und den Anweisungen des zuständigen Klinikpersonals;
 - gemäß den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Betriebsbedingungen;
 - in seiner ursprünglichen, unveränderten Form und nur mit von Breas Medical AB zugelassenem Zubehör.
- Verwenden Sie das Vivo 30 nicht, wenn dessen Beschädigung vermutet wird, es zu unerklärlichen, plötzlichen Druck-, Leistungs- oder Geräuschveränderungen während des Betriebs kommt, oder wenn die vom Vivo 30 kommende Luft ungewöhnlich warm ist oder merkwürdig riecht. Wenden Sie sich in diesen Fällen zwecks einer Überprüfung an das zuständige Pflegepersonal.
- Die unsachgemäße Anwendung des Geräts oder des Zubehörs kann zu Behandlungsverlust oder Leistungsminderung führen.
- Die Einstellungen am Vivo 30 müssen stets auf medizinischer Überwachung basieren und dürfen nur von autorisiertem Klinikpersonal geändert werden. Blutgasmessungen müssen durchgeführt werden, wenn Einstellungen geändert werden oder auf ein anderes Gerät gewechselt wird.

- Führen Sie vor dem Gebrauch des Vivo 30 immer „Überprüfung des Vivo 30 vor der Inbetriebnahme“ auf Seite 25 durch.
- Verwenden Sie nur das von Breas Medical AB empfohlene Zubehör.



- Das Klinikpersonal muss die Gebrauchsanweisung (Klinik) sorgfältig lesen und den Umgang mit dem Vivo 30 genau verstanden haben, bevor das Gerät aufgestellt und verwendet wird.
- Der Anwender muss die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und den Umgang mit dem Vivo 30 genau verstanden haben, bevor das Gerät verwendet wird.
- Sämtliche Alarmer des Vivo 30 müssen so eingestellt werden, dass der Bediener bei möglichen Gefahren effizient gewarnt wird. Beim Einstellen der Alarmgrenzen müssen die Patienteneinstellungen in Betracht gezogen werden. Sämtliche Veränderungen von Einstellungen oder Komponenten/ Zubehör können eine Neueinstellung der Alarmgrenzen erforderlich machen.
- Gehen Sie mit dem Vivo 30 vorsichtig um.
- Verwenden Sie das Vivo 30 nicht, solange es sich in der Tasche befindet. Befestigen Sie die hintere Abdeckung und bringen Sie den Drehwinkel nach unten, wenn Sie das Vivo 30 in der Tasche verstauen.
- Wird das Vivo 30 in der Klinik oder in einem Fahrzeug kurzzeitig transportiert, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
 - Befestigen Sie das Vivo 30 nicht an einem Rollstuhl oder in einem Fahrzeug.
 - Achten Sie darauf, dass das Vivo 30 sicher in aufrechter Position steht und nicht kippen oder umfallen kann.
 - Verwenden Sie das Vivo 30 nicht bei Regen oder Schnee im Freien.
 - Stellen Sie sicher, dass der eventuell angeschlossene Luftbefeuchter HA 20 nicht aktiviert und dessen Wasserbehälter leer ist.

2.2 Elektrische Sicherheit



- Bedienen Sie das Vivo 30 nicht, wenn Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind.
- Es kann zu Funktionsstörungen am Vivo 30 kommen, wenn das Gerät fallengelassen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, unterbrechen Sie vor dem Reinigen des Vivo 30 die Spannungsversorgung. Tauchen Sie das Vivo 30 nicht in Flüssigkeit ein.
- Der Bediener darf nicht gleichzeitig zugängliche Anschlusskontakte und den Patienten berühren.
- Bei der Handhabung der Heizeinheit des HA 20 muss das Vivo 30 grundsätzlich ausgeschaltet und die Netzspannung des Vivo 30 unterbrochen werden.
- Schalten Sie das Vivo 30 stets aus, bevor Sie den Wasserbehälter des HA 20 abnehmen oder anbringen.



- Wird die externe Batterie benutzt, dann trennen Sie diese grundsätzlich vom Gerät ab, wenn das Vivo 30 ausgeschaltet wird. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Batterie entlädt.
- Fällt die Netzspannung aus und wird eine externe Batterie aktiviert, dann wird der Luftbefeuchter HA 20 automatisch ausgeschaltet. Er muss manuell erneut aktiviert werden, wenn während des Batterieeinsatzes eine Luftbefeuchtung erforderlich ist.
- Der Datenanschluss ist ausschließlich vom Pflegepersonal zu verwenden.

2.3 Umgebungsbedingungen



- Verwenden Sie das Vivo 30 niemals in toxischen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Vivo 30 niemals in Umgebungen, in denen explosive Gase oder andere entzündliche anästhetische Mittel vorkommen.
- Wird ein Raumluftheuchter verwendet, platzieren Sie diesen mindestens 2 m vom Vivo 30 entfernt.
- Die Leistung des Vivo 30 kann bei Temperaturen von unter 5 °C und über 38 °C beeinträchtigt werden.



- Verwenden Sie das Vivo 30 nicht, wenn es sich an einem warmen Ort befindet oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Das Gerät entspricht hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit den Anforderungen. Maßnahmen sollten u. a. Folgendes beinhalten:
 - normale Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der relativen Luftfeuchtigkeit und der Leiteigenschaften der Kleidung, um die Bildung elektrostatischer Aufladung zu minimieren;
 - Vermeiden des Gebrauchs von Funkwellen emittierenden Geräten näher als 1 m zum Vivo 30. Einige Beispiele: Funkwellen emittierende Geräte wie Mobilfunk- bzw. schnurlose Telefone, Mikrowellenherde und medizinische Hochfrequenzgeräte.
- Das Vivo 30, jegliches Zubehör und alle ausgetauschten Teile müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltrichtlinien im Hinblick auf die Entsorgung gebrauchter Geräte und Teile entsorgt werden.
- Die Leistung des Vivo 30 und die Behandlung des Patienten können beeinträchtigt werden, wenn die Betriebsbedingungen in „Technische Daten“ auf Seite 54 nicht erfüllt sind. Verwenden Sie das Vivo 30 niemals unmittelbar, nachdem es außerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen gelagert oder transportiert worden ist.

2.4 Verwendung des Patientenschlauchsystems



- Verwenden Sie das Vivo 30 nur mit Masken, Patientenschläuchen und Ausatemventilen (falls verwendet), die von Breas Medical AB und Ihrem Serviceunternehmen empfohlen werden.
- Für den Betrieb des Vivo 30 werden Masken und Schlauchsysteme benötigt, die über Ausatemöffnungen verfügen. Diese dienen zum Abtransport der ausgeatmeten Luft. Prüfen Sie die Durchlässigkeit dieser Ausatemöffnungen vor jeder Anwendung.
- Atmen Sie nur in das angeschlossene Patientenschlauchsystem, wenn das Vivo 30 eingeschaltet ist und vorschriftsmäßig arbeitet.
- Verwenden Sie keine Patientenschläuche aus statischem oder elektrisch leitendem Material.
- Die Komponenten, die mit dem Patienten verbunden sind, müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion des Vivo 30 sicherstellen zu können. Alle ausgetauschten Teile müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltrichtlinien im Hinblick auf die Entsorgung gebrauchter Geräte und Teile entsorgt werden.
- Kontrollieren Sie das Patientenschlauchsystem regelmäßig auf Feuchtigkeit. Entfernen Sie etwaige Feuchtigkeit. Bevor Sie versuchen, das Patientenschlauchsystem zu trocknen, ziehen Sie es so vom Vivo 30 ab, dass kein Wasser in das Vivo 30 zurücklaufen kann.
- Wenn der Patient eine Full-Face-Maske verwendet (die Mund und Nase bedeckt), muss die Maske mit einem Sicherheitsventil versehen sein.

- Stellen Sie sicher, dass die Ausatemöffnungen in der Maske oder im angeschlossenen Ausatemventil nicht verstopft oder blockiert sind. Diese Ausgänge verhindern ein nochmaliges Einatmen der ausgeatmeten Luft. Werden ausgeatmete Atemgase länger als einige Minuten erneut eingeatmet, kann dies zur Erstickung führen.
- Bei niedrigen CPAP-Drücken reicht der Luftdurchfluss durch die Ausatemöffnungen unter Umständen nicht aus, um die ausgeatmeten Atemgase abzuleiten. Es kann zu einem erneuten Einatmen ausgeatmeter Atemgase kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass sich der Patient im Schlaf nicht unbeabsichtigt mit dem Patientenschlauchsystem strangulieren kann.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Maskenherstellers.

2.5 Verwendung von Filtern



- Verwenden Sie das Vivo 30 niemals, ohne dass ein Filter am Patientenluft-einlass installiert ist. Verwenden Sie nur die Filter, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Tauschen Sie die Filter regelmäßig aus bzw. reinigen Sie diese regelmäßig, um die korrekte Funktion des Vivo 30 sicherzustellen, besonders bei einem Patientenwechsel. Wird ein verschmutzter Filter nicht ausgetauscht oder gereinigt, kann dies dazu führen, dass das Vivo 30 mit einer höheren Betriebstemperatur arbeitet als erwünscht.
- Stellen Sie beim Betrieb des Vivo 30 sicher, dass der Lufteinlass und der Filter nicht blockiert oder verstopft sind.
- Die Verwendung eines Bakterienfilters mit hohem Widerstand am Luftauslass des Geräts kann die Patienten-Disconnect-Funktion beeinträchtigen. Dies gilt auch für die Triggerfunktion des Geräts.
- Verwenden Sie keine Bakterienfilter zusammen mit dem Luftbefeuchter HA 20.

2.6 Luftbefeuchtung



- Der Luftbefeuchter HA 20 ist nur für die nicht-invasive Anwendung vorgesehen.
- Die Luftbefeuchtung darf nur auf Verschreibung Ihres Arztes hin erfolgen. Die Vivo 30-Therapieeinstellungen müssen immer von einem Arzt oder anderem befugtem Klinikpersonal verschrieben und von zugelassenem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Trennen Sie stets den Wasserbehälter von der Heizeinheit, bevor Sie das Vivo 30 mit angeschlossenem Luftbefeuchter HA 20 transportieren.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter ab, bevor Sie das Vivo 30 mit dem Luftbefeuchter HA 20 in eine Tragetasche setzen.
- Wenn der Luftbefeuchter HA 20 angeschlossen ist, muss das Vivo 30 auf einer ebenen Fläche und unterhalb des Patienten platziert sein. Dies dient der Verhinderung von Schäden durch versehentliches Verschütten, durch überschüssiges Wasser oder Kondensation im Patientenschlauch und in der Maske. Bei Patienten, die ihre Atemwege nicht selbst schützen oder die Maske nicht selbst abnehmen können, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
- Wenn ein externer Warmluftbefeuchter verwendet wird, muss dieser unter dem Vivo 30 platziert werden, um den Patienten vor Schäden durch versehentliches Verschütten zu schützen.
- Wenn die Kondensation im Patientenschlauchsystem zu stark ist, kann bei Verwendung eines Warmluftbefeuchters die Installation einer Wasserfalle im Patientenschlauchsystem erforderlich sein. Die Wasserfalle verhindert, dass kondensiertes Wasser im Patientenschlauchsystem in die Atemwege des Patienten gelangt und Schäden verursacht.



Die Verwendung eines HME-Filters (Wärme- und Feuchtigkeitstauscher, künstliche Nase) oder eines externen Luftbefeuchters kann eine Neueinstellung des Druck-Tief-Alarms am Vivo 30 erforderlich machen.

2.7 Reinigung und Wartung



- Das Vivo 30 muss gemäß dieser Gebrauchsanweisung gereinigt und gewartet werden.
- Versuchen Sie nicht, das Vivo 30 zu autoklavieren oder zu sterilisieren.
- Wartung, Service und Kontrolle sowie Aktualisierungen des Vivo 30 müssen gemäß den Serviceanweisungen von Breas erfolgen.
- Das Vivo 30 darf nur gemäß dem Breas-Servicehandbuch, den technischen Blättern und den speziellen Serviceanweisungen von Servicepersonal repariert und/oder modifiziert werden, das nach Breas-Schulung dazu befugt ist.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Vivo 30 selbst zu reparieren. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Leistung und Sicherheit des Vivo 30. Dies würde auch zu einem Erlöschen des Anspruchs auf Gewährleistung führen.

2.8 Nebenwirkungen



Wenn der Patient sich unwohl fühlt oder eines der folgenden Symptome bei der Verwendung des Vivo 30 zeigt, sollte sofort ein Arzt oder das verantwortliche Klinikpersonal informiert werden:

- Völlegefühl durch vermehrtes Schlucken von Luft in wachem Zustand
- Kontinuierliches Entweichen von Luft durch den Mund im Schlaf
- Trockenheit der Atemwege oder der Nase
- Ohrenschmerzen, laufende Nase oder Beschwerden der Nebenhöhlen
- Schläfrigkeit am Tag
- Desorientiertheit oder Gedächtnislücken
- Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit
- Empfindlichkeit der Haut

2.9 Verwendung von Sauerstoff



- Das Vorhandensein von Sauerstoff kann das Entzünden von brennbaren Materialien beschleunigen.
- Wenn Sauerstoff verordnet wurde, schließen Sie den Schlauch für die Sauerstoffversorgung an den Sauerstoffanschluss der Nasenmaske oder an einen speziellen Adapter im Patientenschlauchsystem an.
- Bei einem eingestellten Flow des zugeführten Sauerstoffs variiert die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs je nach geliefertem Druck, Atmungsmuster des Patienten, Wahl der Maske oder Höhe der Leckage.
- Wenn zusammen mit dem Vivo 30 Sauerstoff verwendet wird, muss die Sauerstoffzufuhr ausgeschaltet werden, wenn das Vivo 30 außer Betrieb ist.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung des Raums.
- Rauchen Sie nicht in Räumen, in denen Sauerstoff verwendet wird.
- Ungeschützte Lichtquellen und andere Entzündungsquellen müssen mindestens 2 m von der Sauerstoffflasche oder anderen Komponenten des Patientenschlauchsystems entfernt sein.
- Verwenden Sie keine Treibgase oder Lösungsmittel in der Nähe der Sauerstoffversorgung, auch wenn diese ausgeschaltet ist.
- Wenn das Vivo 30 nicht in Betrieb ist und die Sauerstoffversorgung nicht ausgeschaltet wurde, kann es zu einer Ansammlung von Sauerstoff im Patientenschlauch und dem Gerät kommen. Der Sauerstoff, der sich im Schlauch oder Gerät ansammelt, stellt ein Brandrisiko dar.




- Zugeführter Sauerstoff kann den Leckage-Tief-Alarm vorzeitig auslösen.
- Die Sauerstoffzufuhr darf 15 l/min nicht überschreiten.
- Zugeführter Sauerstoff beeinträchtigt die Präzision der Messung von Volumen und Flow.

3 Produktbeschreibung




3.1 Hauptkomponenten

Das Vivo 30-System enthält folgende Komponenten:

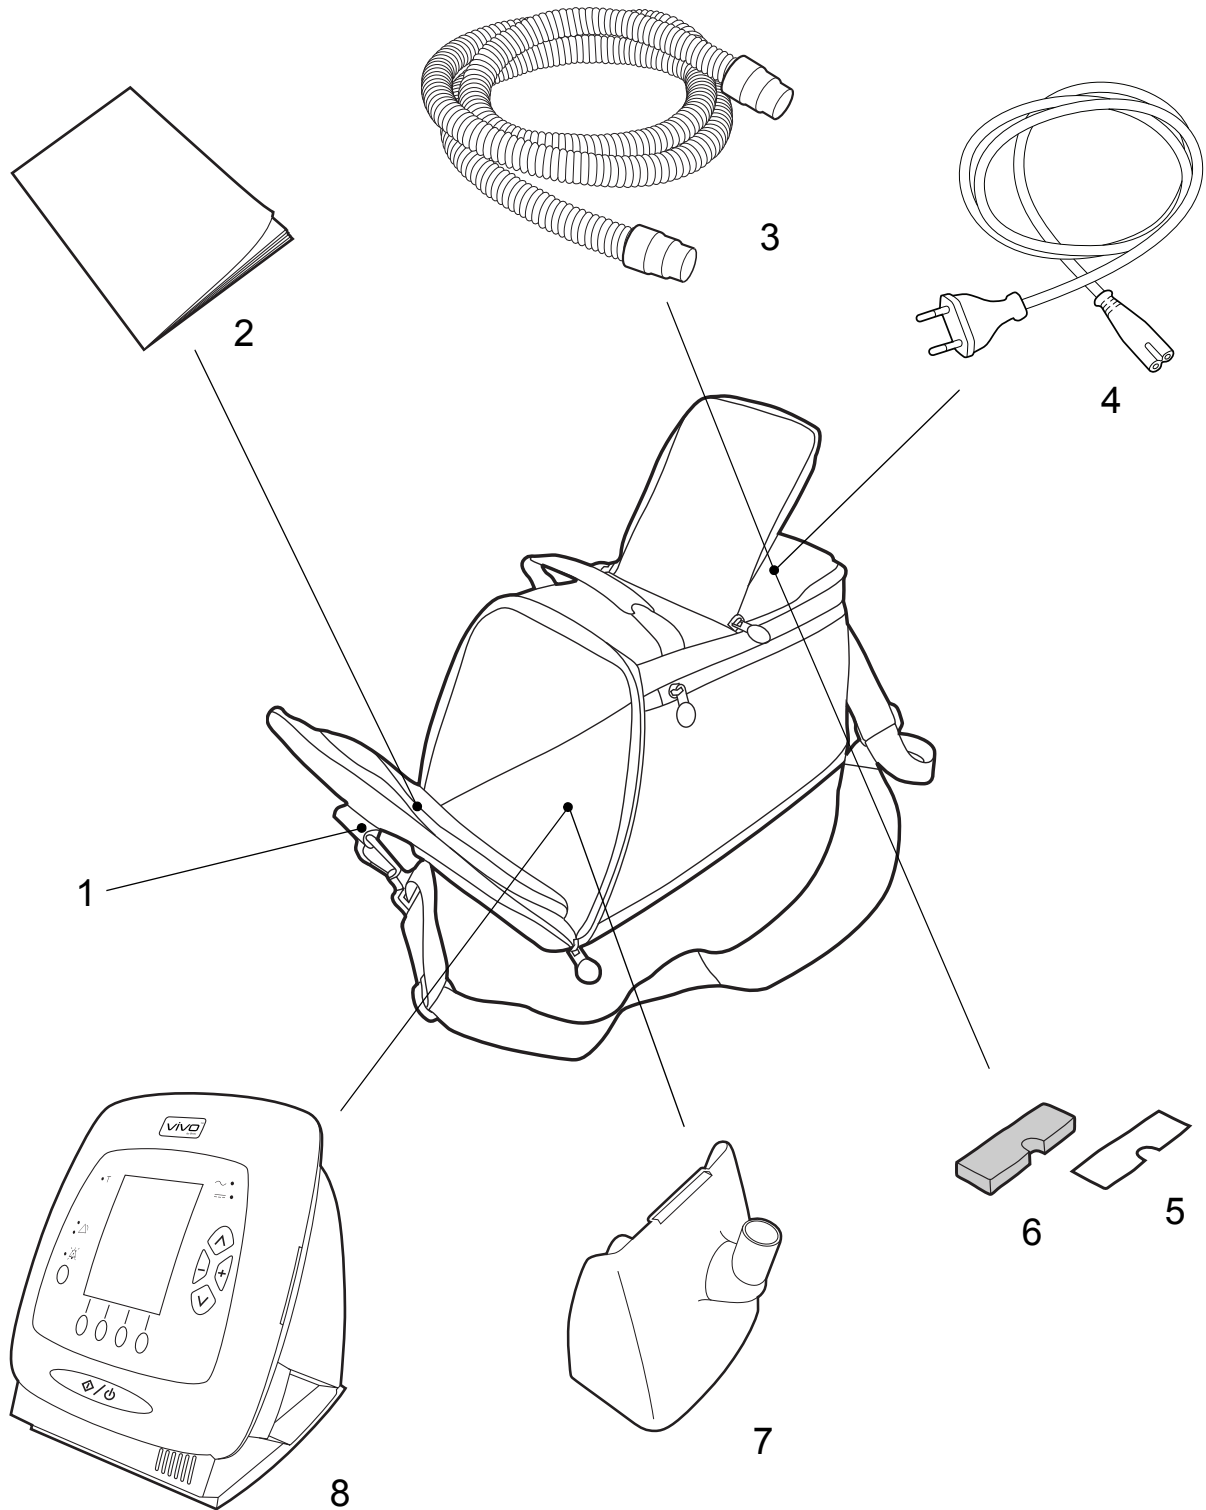


NR.	KOMPONENTE	FUNKTION	ART.-NR.
1	Tragetasche	Aufbewahrung für den Transport	003519
2	Gebrauchsanweisung	Produktinformation	003824
3	Patientenschlauch		000245
4	Netzkabel		003520
5	Filter (weiß, Einweg)	Filterung der Ansaugluft	003526
6	Filter (grau, waschbar)	Filterung der Ansaugluft	003527
7	Hintere Abdeckung	Zur Verwendung ohne Luftbefeuchter HA 20	003591
8	Vivo 30		

3.2 Zubehör

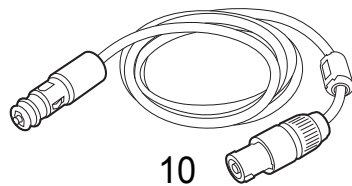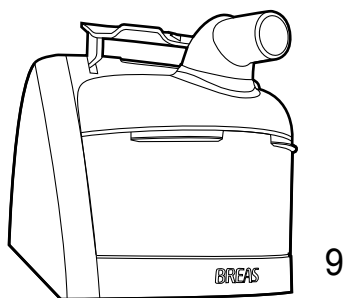

Nr.	KOMPONENTE	FUNKTION	ART.-NR.
9	Luftbefeuchter HA 20	Befeuchtet die Patientenluft	2230 XX
10	Batteriekabel 12/24 V DC		004258
11	EB 2 Batteriesatz	Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> • Ladegerät • Trafobox • Isolierung • Batteriepaket • Tragetasche • Verbindungskabel 24 V AC • Verbindungskabel 24 V DC • Netzkabel • EB 2 Gebrauchsanweisung 	004127

3.3 Das Vivo 30-Bedienfeld

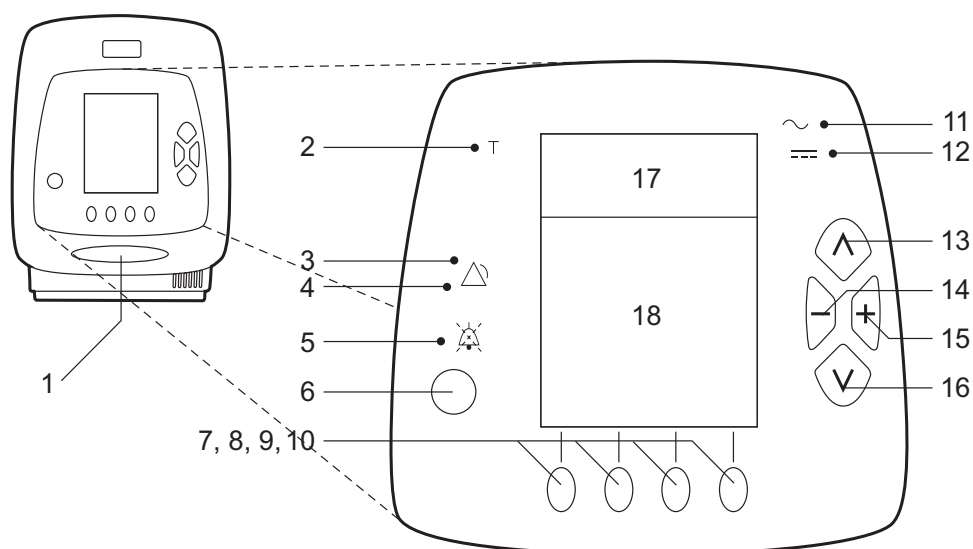


NR.	BEDIENELEMENTE	FUNKTION
1	Start/Stopp	Start/Stopp der Beatmung
6	Stummschaltung	Unterdrückt den Alarmton
7-10	Funktion/Navigation	Funktion gemäß Display
13-16	Navigieren/Einstellen	Navigieren im aktuellen Menü/Einstellungen vornehmen

NR.	LED	FUNKTION
2	Trigger	Triggeranzeige Einatmung
3-4	Alarm (rot & gelb)	Alarmanzeige
5	Stummschaltung	Anzeige der Alarmtonunterdrückung
11	Netzspannung	Spannungsquelle: Netzspannung
12	Externe Batterie	Spannungsquelle: Externe Batterie


NR.	DISPLAY	FUNKTION
17	Überwachungsbereich	Aktuelle Behandlungsdaten
18	Aktiver Bereich	Veränderbare Einstellungen



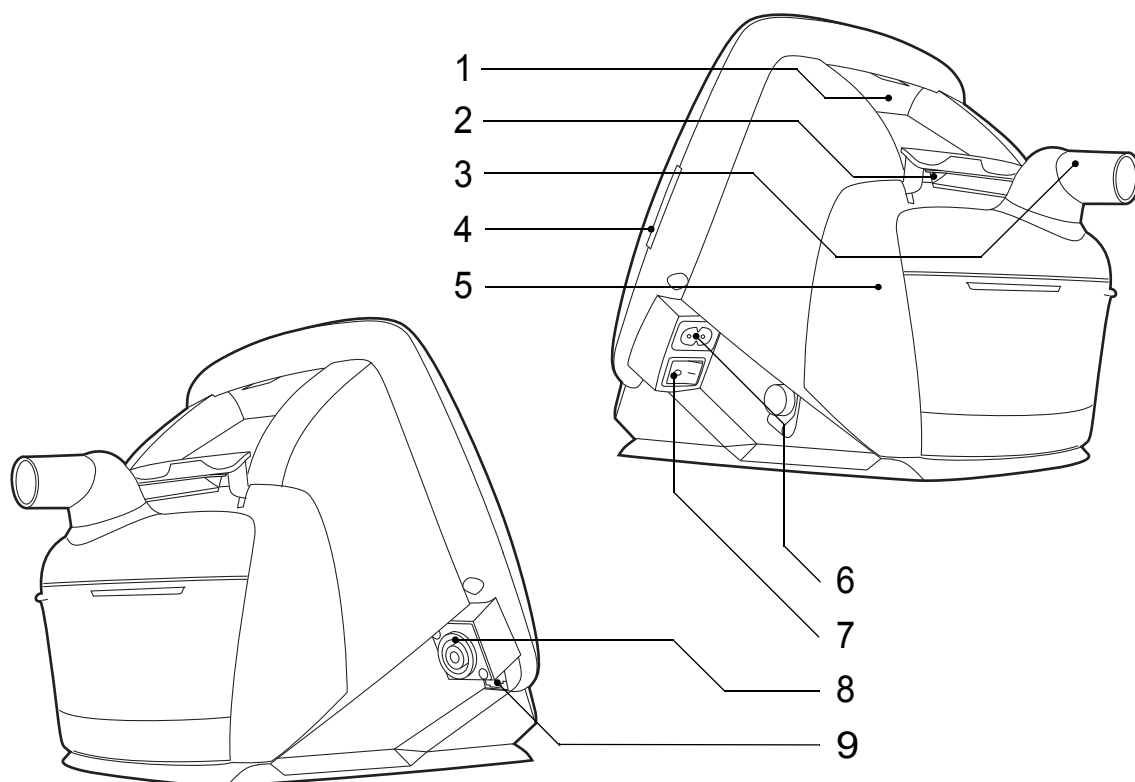





3.4 Die Rück- und Seitenteile des Vivo 30

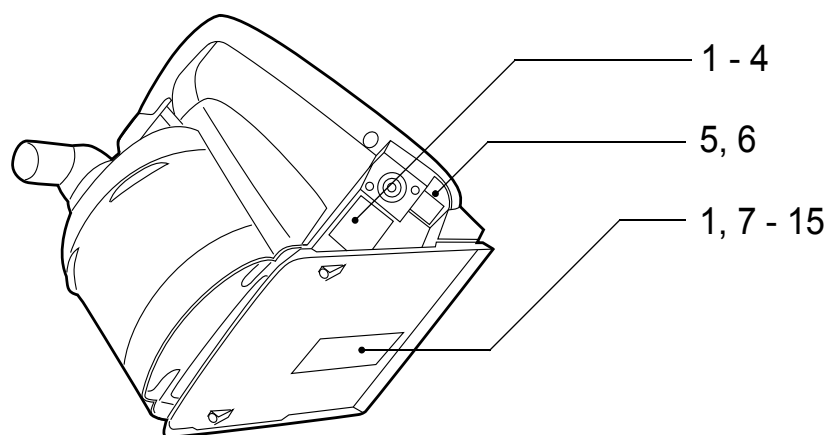







Nr.	Gegenstand	Funktion
1	Lufteinlass	Luftweg ins Gerät, austauschbare Filter
2	Sperrmechanismus	Ent- und Verriegeln des Luftbefeuchters HA 20 oder der hinteren Abdeckung
3	Luftauslass	Luftweg zum Patienten
4	Steckplatz für Speicherkarte	Liest/Beschreibt die Speicherkarte
5	Luftbefeuchter HA 20	Befeuchtung der Patientenluft
6	Netzanschlussbuchse	Anschluss einer externen Spannungsversorgung
7	Ein/Aus	Netzspannung ein/aus
8	Externer Batterieanschluss	Externe DC-Spannungsversorgung
9	Datenanschluss	Datenkabelanschluss Der Datenanschluss ist ausschließlich vom Pflegepersonal zu verwenden.

3.5 Typenschild und Sicherheitssymbole



NR.	SYMBOL	ERLÄUTERUNG
1		Typenbezeichnung
2		Produktnummer
3		Seriennummer
4		Herstellungsdatum JJJJ-MM
5		Datenanschluss (Der Datenanschluss ist ausschließlich vom Pflegepersonal zu verwenden.)
6		Vorsicht. Der Datenanschluss ist ausschließlich vom Pflegepersonal zu verwenden.
7		Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
8		Vorsicht. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie das Vivo 30 benutzen.
9		Geräte der Schutzklasse II; schutzisoliert.

NR.	SYMBOL	ERLÄUTERUNG
10		Schutzklasse BF (IEC 60601-1 Typ BF, Isoliertes Anwendungsteil)
11		Zertifiziert durch CSA.
12		Das CE-Zeichen gibt an, dass das Gerät der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht.
13		Zertifiziert durch GOST-R.
14		Lesen Sie „Entsorgung“ auf Seite 53 für Informationen über Wiederverwertung und Entsorgung.
15		Hersteller

4 Funktionen und Parameter des Vivo 30

In diesem Kapitel werden die zur Steuerung der Beatmung durch das Vivo 30 verwendeten Modi und Parameter beschrieben.

4.1 Beatmungsmodus

Am Vivo 30 können folgende Modi eingestellt werden:

- PCV-Modus (Pressure Control Ventilation)
- PSV-Modus (Pressure Support Ventilation)
- CPAP-Modus (Continuous Positive Airway Pressure)

4.2 Einstellungen

Rampenfunktion (optional)

Die Rampenfunktion dient zur Erhöhung von EPAP- und IPAP-Druck während einer festgesetzten Zeit; der IPAP-Druck beginnt bei 2 hPa (mbar) über dem Rampenstartdruck.

Im CPAP-Modus sorgt die Rampenfunktion für einen Anstieg vom Rampenstartdruck auf den eingestellten CPAP-Druck in einer festgelegten Zeit.



Der Druck-Tief-Alarm ist während der Rampenzeit inaktiv.

4.3 Standby- und Betriebsmodus

Der Standby-Modus ist definiert als der Status des Vivo 30, wenn die Netzspannung angeschlossen und der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist, aber ohne Start des Vivo 30 mit dem Start/Stopp-Schalter.

Der Betriebsmodus ist definiert als der Status des Vivo 30, wenn das Gebläse in Betrieb ist und einen Luftstrom erzeugt.

Gehen Sie in den Betriebsmodus, indem Sie das Vivo 30 einschalten (siehe „Ein- und Ausschalten des Vivo 30“ auf Seite 26). Gehen Sie in den Standby-Modus, indem Sie das Vivo 30 wieder ausschalten.

Einige Betriebsschritte wie z. B. der Zugriff auf die Speicherkarte und die Einstellung von Zeit und Datum sind nur im Standby-Modus möglich.

4.4 Erkennung Leckage Tief

Das Vivo 30 stellt automatisch fest, ob die am Gerät angebrachten Maske und Schläuche ausreichend durchlässig sind. Wenn die gemessene Durchlässigkeit unter dem empfohlenen Wert liegt, wird ein Leckage-Tief-Alarm ausgelöst. Das Vivo 30 setzt das Beatmen während des Alarms fort.



Überprüfen Sie Maske und Schläuche und reinigen Sie die Ausatemöffnungen, falls sie verstopft sind.

4.5 Luftbefeuchter (optional)

Die Luftbefeuchterfunktion ist einstellbar, um die Patientenluft mit zusätzlicher Feuchtigkeit anzureichern.

5 Verwendung des Vivo 30

5.1 Überprüfung des Vivo 30 vor der Inbetriebnahme

Vor der Verwendung des Vivo 30 führen Sie bitte folgende Schritte durch:


- 1** Schließen Sie ein gereinigtes oder neues Patientenschlauchsystem an das Vivo 30 an.
- 2** Schließen Sie das Vivo 30 an die Netzsteckdose an.
- 3** Schalten Sie das Vivo 30 an, indem Sie den Ein/Aus-Schalter am seitlichen Bedienfeld betätigen.
- 4** Drücken Sie den Start/Stop-Schalter vorn am Bedienfeld. Achten Sie darauf, dass ein kurzes Signal ertönt. Wenn kein Signal ertönt, darf das Vivo 30 nicht verwendet werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.
- 5** Trennen Sie das Netzkabel länger als 5 s ab. Überprüfen Sie, ob das akustische Netzausfallsignal ertönt. Wenn kein Netzausfallsignal ertönt, darf das Vivo 30 nicht verwendet werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.
- 6** Schließen Sie das Netzkabel wieder an. Nun muss der Alarmton verstummen.
- 7** Legen Sie die Maske an und überprüfen Sie den korrekten Sitz.
- 8** Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen vorschriftsmäßig vorgenommen wurden.

Das Vivo 30 ist nun einsatzbereit.


5.2 Ein- und Ausschalten des Vivo 30

Einschalten

1 Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung angeschlossen und der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist.

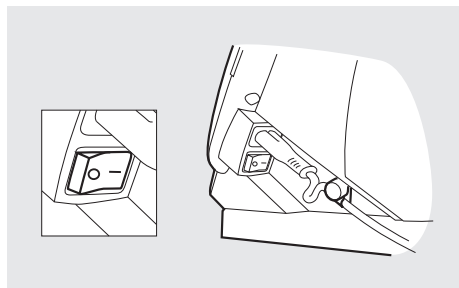


2 Schalten Sie das Vivo 30 ein, indem Sie den Start/Stop-Schalter vorn am Bedienfeld 2 s lang betätigen. Ein kurzes Signal ist zu hören.

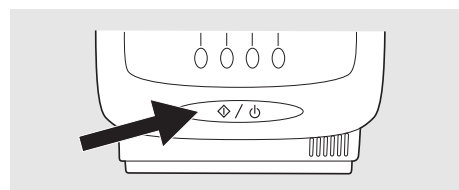


Ausschalten


1 Halten Sie den Start/Stop-Schalter vorn am Bedienfeld 2 s (höchstens 4 s) lang gedrückt.

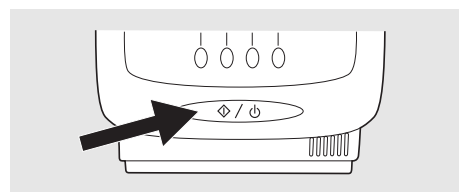

2 Lassen Sie den Start/Stop-Schalter los, wenn die Mitteilung im Display erscheint.

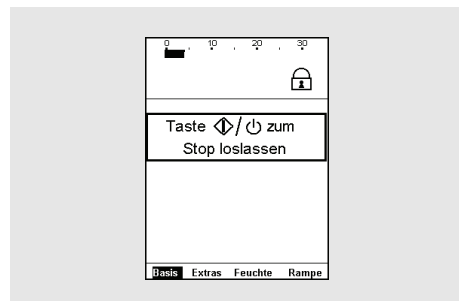


3 Schalten Sie das Vivo 30 durch nochmaliges Betätigen des Start/Stop-Schalters aus.

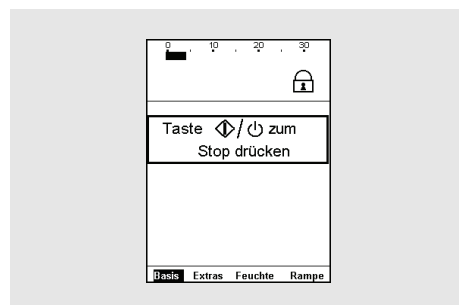


5.3 Arbeiten mit dem Menü

Verwenden Sie die vier Navigationstasten und die Tasten „Auf“, „Ab“, „+“ und „-“ auf dem Bedienfeld, um sich im Vivo 30-Menü zu bewegen.

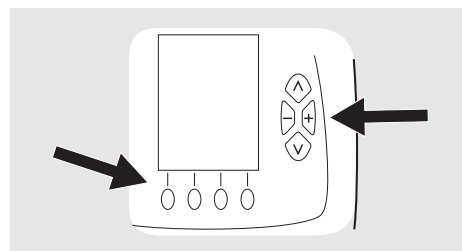


Die genauen Positionen der Tasten entnehmen Sie Kapitel „Das Vivo 30-Bedienfeld“ auf Seite 19.

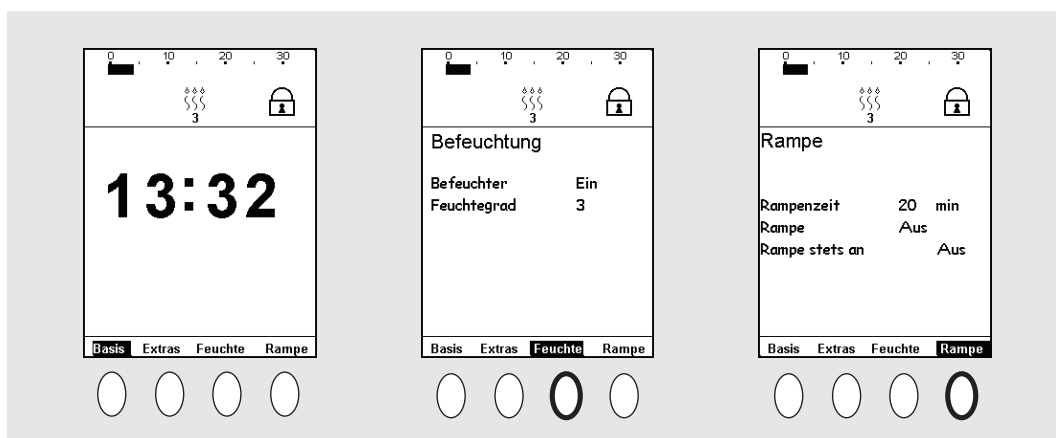

Die Navigationstasten werden verwendet, um die verschiedenen Bereiche anzuzeigen, die über der jeweiligen Navigationstaste angegeben sind. Sie können dieselben Navigationstasten verwenden, um sich in einigen Bereichen zusätzliche Information anzeigen zu lassen.





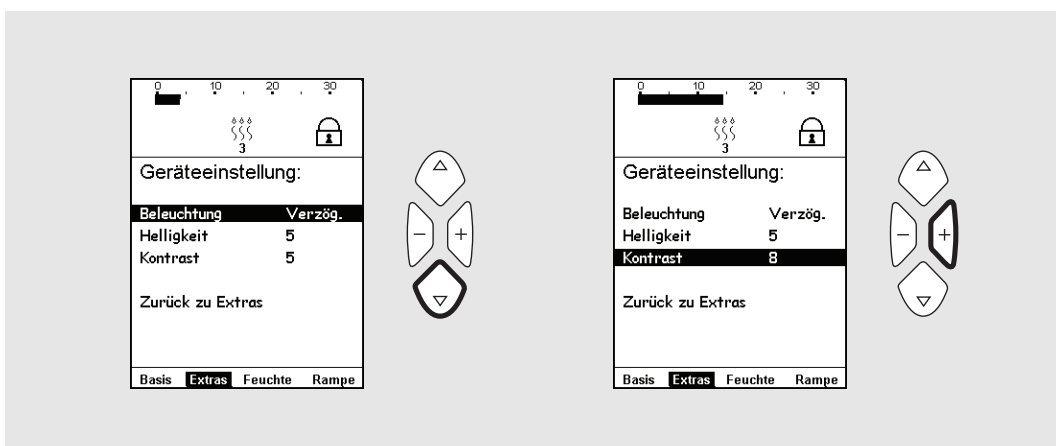


Betätigen Sie die Tasten „Auf“ oder „Ab“, um die Menüleiste zu öffnen. Während des Betriebs und wenn 20 s lang keine Taste betätigt wurde, schaltet das Menü automatisch auf die Uhr.




Die Tasten „Auf“ und „Ab“ werden verwendet, um in einem Bereich Werte festzulegen. Die Tasten „+“ und „-“ werden zum Ändern eines Werts verwendet.

Symbole des Menüs

SYMBOL	BESCHREIBUNG	EINHEIT
	Weckzeit aktiv	Stunde : Minute
	Luftbefeuchter HA 20 aktiv	1 bis 9, Aus
	Rampe ein	Minute
	Bedienfeld gesperrt	Ein, Aus
	Bedienfeld durch die PC-Software des Breas Vivo gesperrt	Ein, Aus


Überblick

Das Vivo 30-Menü hat folgenden Aufbau:

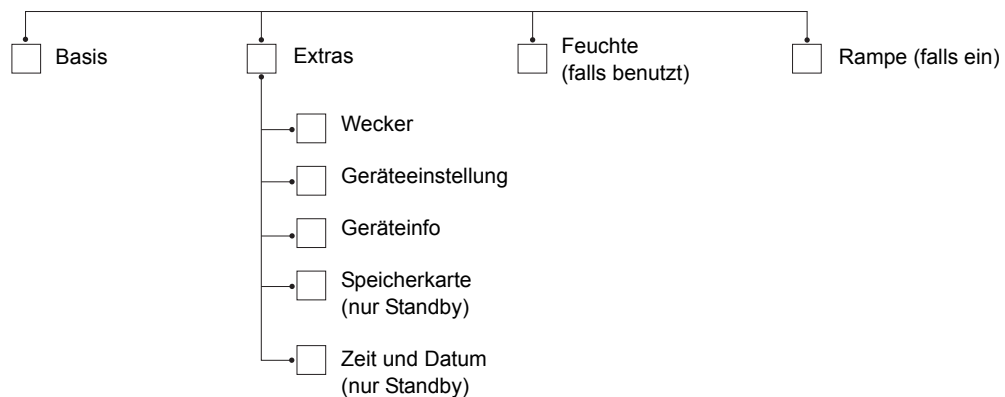

Basis-Menü

Der Überwachungsbereich enthält eine Skalenanzeige für den aktuellen Druck, Informationen über die Weckzeit, den Luftbefeuchter HA 20, die verbleibende Rampenzeit und die Bedienfeldsperrung.

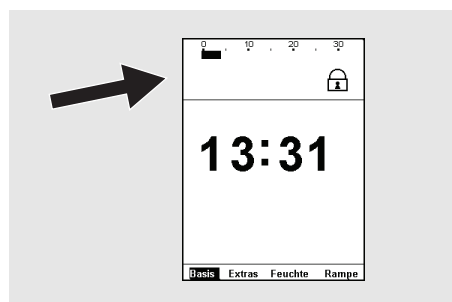

Das „Extras“-Menü

Die Menüleiste für das „Extras“-Menü im Standby-Modus (mit dem Luftbefeuchter HA 20 angeschlossen).




Die Menüleiste für das „Extras“-Menü im Betriebsmodus.




Wecker

Gehen Sie in den Bereich „Extras“ und wählen Sie „Wecker“, um auf die Seite „Wecker“ zu gelangen.

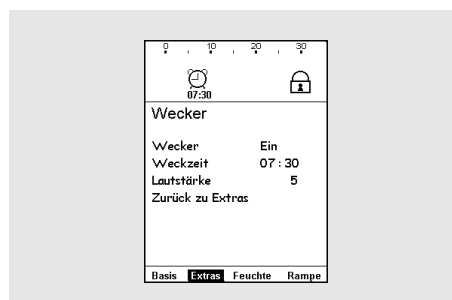

Geräteeinstellung

Gehen Sie in den Bereich „Extras“ und wählen Sie „Geräteeinstellung“, um auf die Seite „Geräteeinstellung“ zu gelangen.

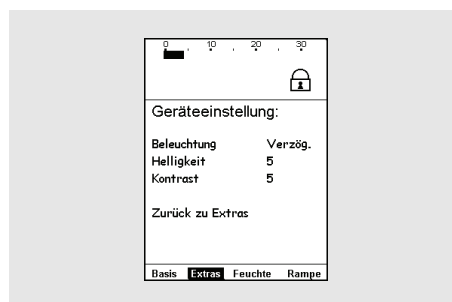


Geräteinfo

Gehen Sie in den Bereich „Extras“ und wählen Sie „Geräteinfo“, um auf die Seite „Geräteinfo“ zu gelangen.



Zeit und Datum


Gehen Sie in den Bereich „Extras“ und wählen Sie „Zeit und Datum“, um auf die Seite „Zeit und Datum“ zu gelangen.

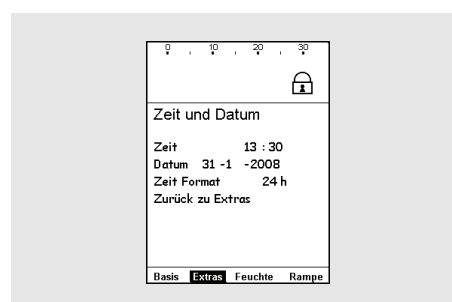

5.4 Überwachungsbereich

Im Überwachungsbereich werden die aktuellen Behandlungsdaten angezeigt. Der Überwachungsbereich liegt im oberen Teil des Displays:

Der Überwachungsbereich enthält eine Skalenanzeige für den aktuellen Druck, Informationen über die Weckzeit, den Luftbefeuchter HA 20, die verbleibende Rampenzeit und die Bedienfeldsperrung.

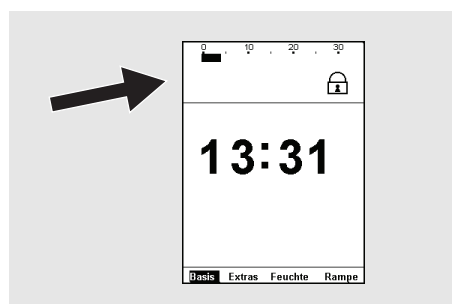

5.5 Verwendung des Luftbefeuchters HA 20



Sicherheitshinweise, Warnvorschriften, Produktbeschreibung, Installations-, Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungsvorschriften sowie technische Daten entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung für den Breas Luftbefeuchter HA 20.



Lesen Sie das Kapitel „Luftbefeuchtung“ auf Seite 13 aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen erfüllt und beachtet wurden.




Fällt die Netzspannung aus und wird eine externe Batterie aktiviert, dann wird der Luftbefeuchter HA 20 automatisch ausgeschaltet. Er muss manuell erneut aktiviert werden, wenn während des Batterieeinsatzes eine Luftbefeuchtung erforderlich ist.

Der Luftbefeuchter HA 20 dient der Befeuchtung der Atemluft des Patienten. Der Luftbefeuchter HA 20 muss stets installiert sein, um auf die Einstellungen des Luftbefeuchters im Vivo 30-Menü zugreifen zu können. Der Luftbefeuchter HA 20 kann nur während des Betriebs des Vivo 30 aktiviert werden.

Navigieren Sie zur Seite „Feuchte“. Der Einstellbereich für den Feuchtegrad geht von 1 bis 9, wobei 9 der maximale Feuchtegrad ist.

Stellen Sie die Feuchte immer auf den von Ihrem Arzt empfohlenen Wert ein.

Der Luftbefeuchter HA 20 kann aktiviert und deaktiviert werden, wenn Sie die Luftbefeuchter-Taste über 1 s lang betätigen.

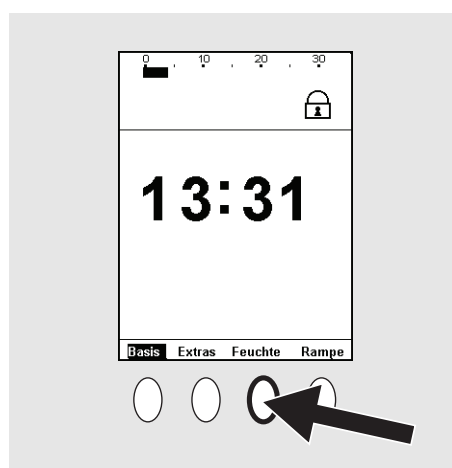

Wird der Luftbefeuchter HA 20 nach Gebrauch vorschriftsmäßig abgenommen und wieder angeschlossen (siehe Gebrauchsanweisung des Luftbefeuchters HA 20), wird vom Vivo 30 die eingestellte Feuchte-Einstellung weiter verwendet.

5.6 Verwendung der Batterien

Die Batterie dient als Notspannungsversorgung, wenn die primäre Spannungsversorgung ausfällt.

Spannungsversorgungspriorität

- 1 Netzspannung
- 2 Externe Batterie

Wenn die Netzspannung ausfällt, schaltet das Vivo 30 auf die externe Batterie um (falls vorhanden) und setzt eine Meldung im Display ab.



Die Verwendung des Luftbefeuchters HA 20 während des Batteriebetriebs reduziert die Batterielaufzeit erheblich.


Externe Batterie

Das Vivo 30 kann mit einer externen 24-V- oder 12-V-Gleichstrom-Batterie betrieben werden.

- Verwenden Sie das Batteriekabel 12/24 V DC oder das externe Batteriepaket Breas EB 2. Wenn eine andere DC-Versorgung als das externe Batteriepaket Breas EB 2 verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Spannung 12 oder 24 V beträgt.
- Überprüfen Sie die Polarität der externen Batterie, bevor Sie diese an das Vivo 30 anschließen.

Wenn eine externe Batterie angeschlossen ist, schaltet das Vivo 30 automatisch auf diese um, wenn das Netzkabel gezogen wird oder ein Fehler in der Netzspannungsversorgung vorliegt. Der externe DC-Wert ist im Menü „Extras“ unter „Geräteinfo“ angegeben.

- 1 Schließen Sie das externe Batteriekabel an das Vivo 30 an. Achten Sie darauf, dass es korrekt angeschlossen wird.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Batterie an.

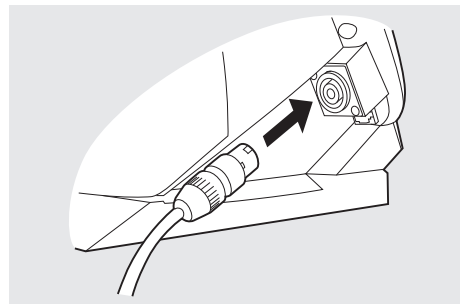



- Verwenden Sie ausschließlich ein externes Breas-DC-Kabel zum Anschluss des Vivo 30 an die externe Batterie.
- Eine externe Batterie muss nach Ausschalten des Vivo 30 abgetrennt werden, da sie sich sonst entladen kann.

Betriebszeit der externen Batterie

Die Betriebszeit hängt vom Zustand der Batterie, ihrer Kapazität, der Umgebungstemperatur und den Einstellungen des Vivo 30 ab.


EINSTELLUNG	WERT
EPAP	8
IPAP	20
Atemfrequenz	15

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur	20 °C
Höhe	Normalnull

Mit den oben angegebenen Einstellungen beträgt die Betriebszeit bei einem vollständig geladenen, neuen Batteriepaket Breas EB 2 etwa 6 Stunden.

5.7 Vivo 30 Betriebszeit

Das Vivo 30 zeichnet zwei Arten von Betriebszeiten auf. Sie gehen aus der Seite „Extras“ unter „Geräteinfo“ hervor.

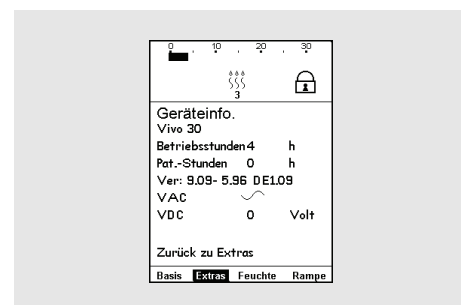

Betriebsstunden

Zeigt die Gesamtanzahl Stunden, die das Vivo 30 in Betrieb war.

Patientenstunden

Zeigt die Gesamtanzahl Stunden, die ein Patient mit dem Vivo 30 therapiert wurde.

6 Vorbereitung des Vivo 30



Vor dem Aufstellen und Verwenden des „Sicherheitshinweise“ auf Seite 7 ist das Kapitel Vivo 30 zu lesen.

6.1 Installation des Vivo 30

Beim ersten Gebrauch des Vivo 30 beachten Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:


1 Überprüfen Sie, ob alle Hauptkomponenten und bestellten Zubehörteile geliefert wurden (nehmen Sie hierzu, falls vorhanden, den Lieferschein oder die Rechnung zu Hilfe).



2 Stellen Sie sicher, dass sich die Ausrüstung in gutem Zustand befindet.

3 Sollte das Vivo 30 länger als einen Monat gelagert worden sein, schließen Sie es an die Netzspannung an und schalten Sie den Ein/Aus-Schalter ein, um die Alarmbatterie im Standby-Modus wieder aufzuladen.

4 Stellen Sie sicher, dass die Luftfilter installiert sind.

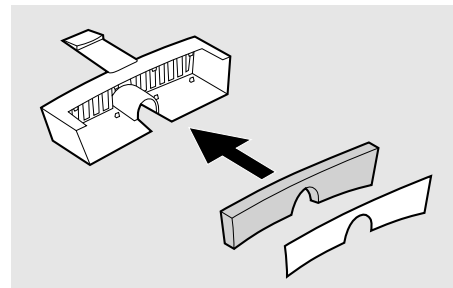


6.2 Aufstellen des Vivo 30




Lesen Sie das Kapitel „Umgebungsbedingungen“ auf Seite 10 aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen erfüllt und beachtet wurden.

1 Stellen Sie das Vivo 30 auf eine stabile, ebene Fläche und zum Patienten weisend. Das Vivo 30 sollte unterhalb des Patienten stehen, damit das Gerät nicht auf ihn fallen kann und das Kondenswasser ihn nicht erreicht.

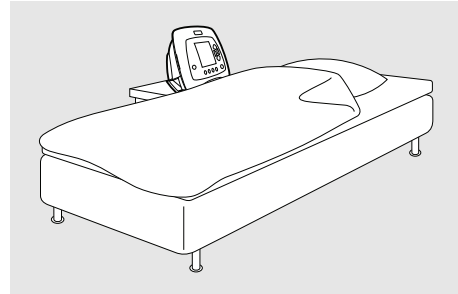

2 Stellen Sie sicher, dass der Patienten-Lufteinlass an der Rückseite des Vivo 30 nicht versperrt wird.

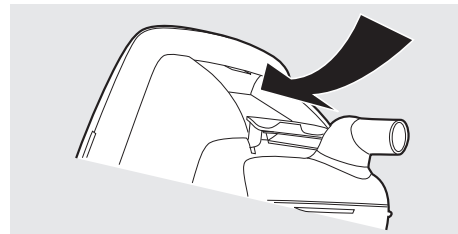


6.3 Anschluss des Vivo 30 an das Stromnetz




Lesen Sie das Kapitel „Elektrische Sicherheit“ auf Seite 9 aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen erfüllt und beachtet wurden.

Anschluss des Vivo 30 an das Stromnetz:


1 Stecken Sie das Netzanschlusskabel in die Netzanschlussbuchse des Vivo 30.

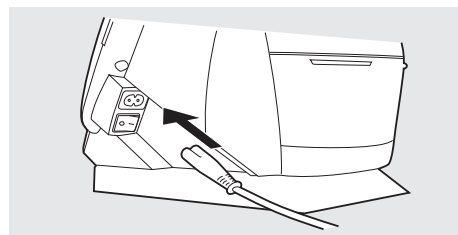

2 Biegen Sie das Kabel leicht zu einem U, damit es nicht gestreckt wird. Befestigen Sie das Netzkabel mit dem Kabelhalter.

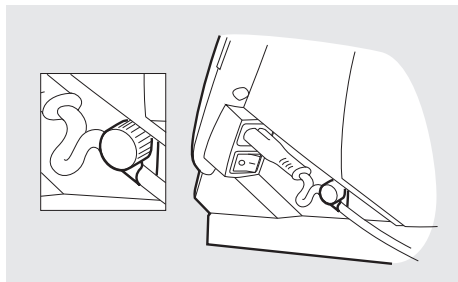

3 Schließen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzsteckdose an.

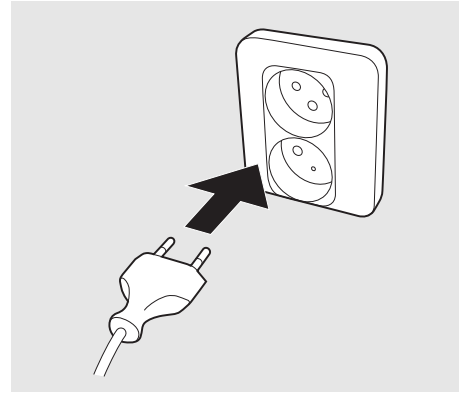


6.4 Anschluss des Patientenschlauchsystems



Lesen Sie das Kapitel „Verwendung des Patientenschlauchsystems“ auf Seite 11 aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen erfüllt und beachtet wurden.

1 Schließen Sie den Patientenschlauch an den Luftauslass an.

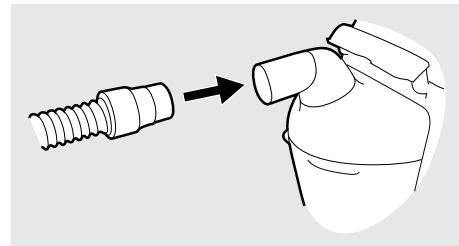

2 Schließen Sie das andere Ende des Patientenschlauchs an die Maske und, falls vorhanden, das Ausatemventil an.

Empfohlene Leckage

Die Leckage von Patientenmaske oder Ausatemventil sollte mindestens 12 l/min bei 4 hPa (mbar) betragen, um ein unerwünschtes erneutes Einatmen der ausgeatmeten Luft zu vermeiden. Die empfohlene Maskenleckage beträgt 20 bis 40 l/min bei 10 hPa (mbar) Druck.

Die Leckage wird erreicht durch:

- integrierte Leckage in der Maske
- ein angeschlossenes Ausatemventil

7 Alarme



Die einstellbaren Alarmgrenzen sollten jedes Mal, wenn Beatmungseinstellungen am Vivo 30 verändert werden, neu angepasst werden.

In diesem Kapitel werden die Alarmfunktionen für das Vivo 30 beschrieben.

7.1 Alarmfunktion

Die Alarmfunktion des Vivo 30 besteht aus den Alarm-LEDs auf der Vorderseite des Geräts, einem akustischen Alarmton sowie Meldungen auf dem Display (siehe „Das Vivo 30-Bedienfeld“ auf Seite 19 für einen Überblick über die Position der LEDs und das Display).

Alarmanzeige




Achten Sie stets darauf, dass die Lautstärke des Alarms an den Umgebungsgeräuschpegel angepasst wird.



Sobald ein Alarm eingestellt ist, setzt das Vivo 30 unverzüglich einen Alarm ab.

Wenn ein Alarmzustand eintritt, wird der Alarm auf drei Arten angezeigt:


- Farbige LED auf dem Bedienfeld:
Gibt die Priorität des aktiven Alarms an.
 - Hohe Priorität: rot, blinkt 2 Mal pro s
 - Mittlere Priorität: gelb, blinkt alle 2 s
- Alarmtext im Display: Zeigt den Namen des aktiven Alarms an.

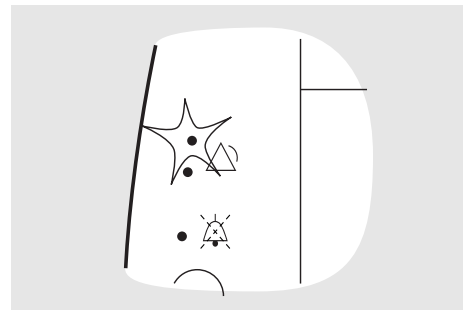

- Akustische Signale: Gibt die Priorität des aktiven Alarms an.
 - Hohe Priorität: 3 Signale gefolgt von 2 weiteren. Die Signalfolge wird nach 0,5 s Pause wiederholt.
 - Mittlere Priorität: Nur 3 Signale, mit niedrigerer Frequenz als der Hochprioritätsalarm. Die Signalfolge wird nach 6 s Pause wiederholt.
 - Funktionsfehler: Dasselbe Signal wie der Hochprioritätsalarm oder ein konstantes Signal, je nach Art des Funktionsfehlers.

Akustisches Alarmsignal – Stummschaltung und Reaktivierung

Das akustische Alarmsignal kann stummgeschaltet werden, indem die Taste „Stummschaltung“ gedrückt wird. Wenn das Beatmungsgerät nach 60 s immer noch denselben Alarm registriert und die Taste „Stummschaltung“ gedrückt war, ertönt das akustische Alarmsignal erneut.

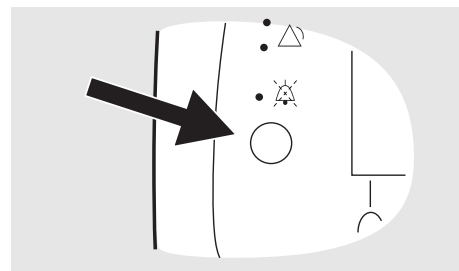

Nachdem das akustische Alarmsignal stummgeschaltet wurde, kann es durch erneutes Drücken der Taste „Stummschaltung“ (2 s) wieder aktiviert werden. Wenn während der Stummphase ein neuer Alarmzustand eintritt, wird das akustische Alarmsignal erneut aktiviert.



Zur Sicherstellung der zeitlichen Erkennung eines neuen Alarmzustands dürfen Sie den Patienten während der Stummschaltung des akustischen Alarmsignals niemals unbeaufsichtigt lassen.

Alarmrückstellung

Ein Alarm wird automatisch rückgestellt, sobald die Ursache für den Alarm behoben ist.




Falls ein Alarmzustand nicht behoben werden kann, unterbrechen Sie die Behandlung und veranlassen einen Service für das Vivo 30.

7.2 Physiologischer Alarm

Druck-Tief-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Druck-Tief-Alarm wird ausgelöst, wenn der Druck des Vivo 30 innerhalb von 15 s nicht die Alarmgrenze für Druck-Tief erreicht.
Mögliche Ursache	<ul style="list-style-type: none">• Diskonnektion des Patientenschlauchsystems.• Einstellung ist höher als IPAP.• Leckage der Maske oder anderer Komponenten im Patientenschlauchsystem.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 setzt das Beatmen mit denselben Einstellungen fort.

Anzeige

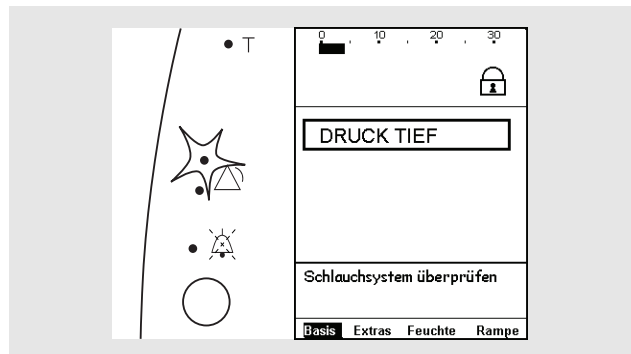


Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit hoher Priorität und optisch über die rote Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Druck-Hoch-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Druck-Hoch-Alarm wird abgesetzt, wenn der Druck des Vivo 30 drei aufeinanderfolgende Atemzüge lang 10 hPa (mbar) über dem IPAP liegt.
Mögliche Ursache	Wird nur in Ausnahmefällen aktiviert, wie z. B. bei starkem Husten während der Inspirationsphase des Beatmungsgeräts.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 beendet die Inspiration bei dem ersten Druck-Hoch-Atemzug. Das Vivo 30 setzt darauf das Beatmen mit denselben Einstellungen fort.

Anzeige

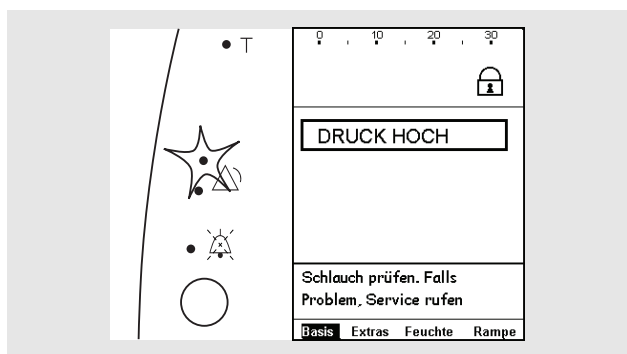


Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit hoher Priorität und optisch über die rote Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Volumen-Tief-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Volumen-Tief-Alarm wird ausgelöst, wenn das Volumen des Vivo 30 innerhalb von 15 s nicht die Alarmgrenze für Volumen Tief erreicht (45 s nach dem Start und nach dem Abbruch eines Leckage-Hoch-Alarms).
Mögliche Ursache	<ul style="list-style-type: none">• Behinderung in den Luftwegen.• Verstopftes oder blockiertes Patientenschlauchsystem.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 setzt das Beatmen mit denselben Einstellungen fort.

Anzeige

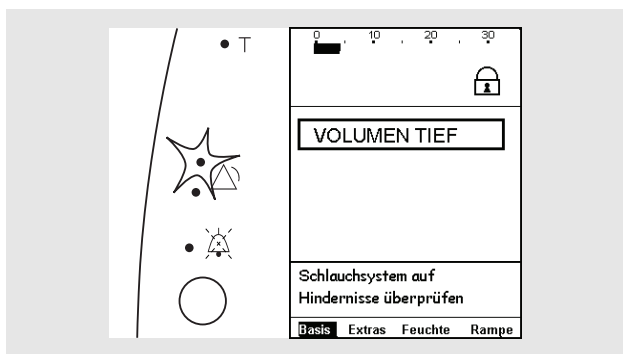


Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit hoher Priorität und optisch über die rote Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Leckage-Tief-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Leckage-Tief-Alarm wird ausgelöst, wenn der gemessene Flow niedriger ist als der erwartete Leckage-Flow bei eingestelltem Druck.
Mögliche Ursache	<ul style="list-style-type: none">• Fehlende bzw. fehlerhafte Leckage im Patientenschlauchsystem.• Verstopftes oder blockiertes Patientenschlauchsystem.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 versucht, weiter Atemzüge gemäß den Einstellungen zu liefern.

Anzeige

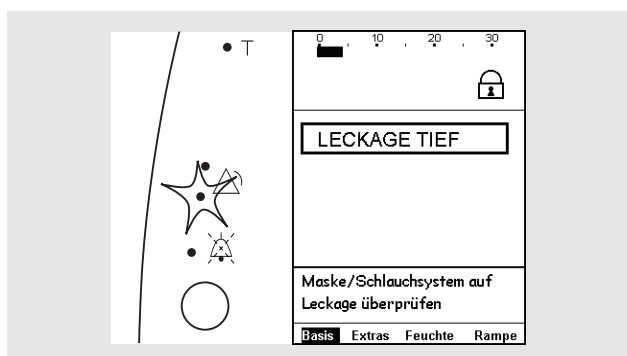


Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit mittlerer Priorität und optisch über die gelbe Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Leckage-Hoch-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Leckage-Hoch-Alarm wird ausgelöst, wenn der gemessene Flow den erwarteten Leckage-Flow bei eingestelltem Druck länger als 15 s überschreitet.
Mögliche Ursache	<ul style="list-style-type: none">• Leckage im Patientenschlauchsystem.• Der Patient hat die Maske abgenommen.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 versucht, weiter Atemzüge gemäß den Einstellungen zu liefern.

Anzeige

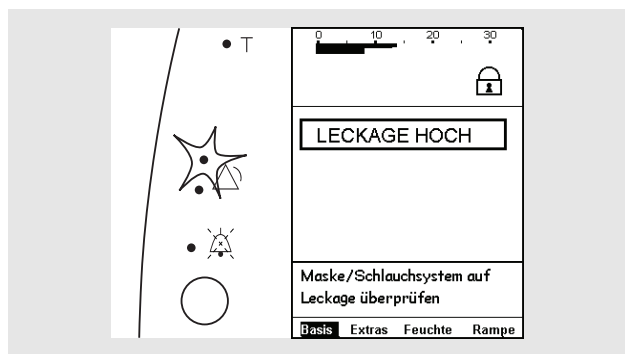


Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit hoher Priorität und optisch über die rote Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

7.3 Technischer Alarm

Warnung für Externe Batterie-Tief

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Eine Warnung für externe Batterie-Tief wird ausgelöst, wenn die externe Batterie die letzte Spannungsquelle ist und unter die Warngrenze absinkt.
Mögliche Ursache	Eine entladene externe Batterie.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 setzt das Beatmen mit denselben Einstellungen fort.

Anzeige

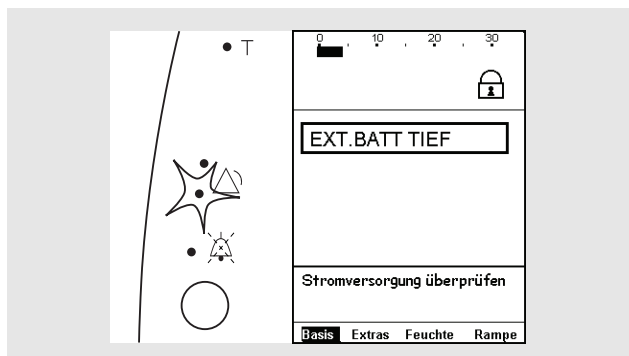


Die Warnung wird durch ein akustisches Signal mit mittlerer Priorität und optisch über die gelbe Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Spannung-Tief-Alarm

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Spannung-Tief-Alarm wird ausgelöst, wenn die letzte Spannungsquelle unter die Spannungs-Alarmgrenze abgesunken ist.
Mögliche Ursache	<ul style="list-style-type: none">• Unterbrochene Verbindung zur Netzspannung.• Keine Batteriespannung.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 hört auf, Atemzüge zu liefern, und löst einen 2 min langen Alarm aus. Bei einer Verbindung zur Netzspannung mit zu niedriger Spannung wechselt das Vivo 30 in den Standby-Modus.

Anzeige

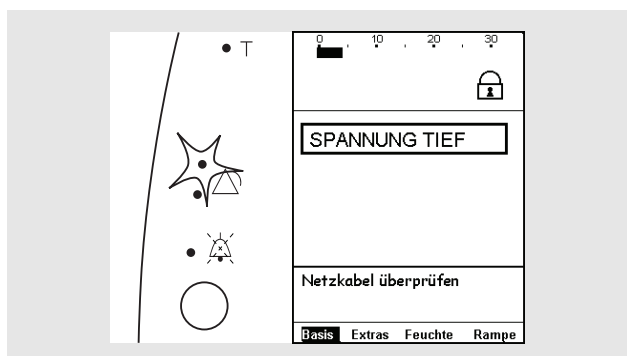

Der Alarm wird durch ein akustisches Signal mit hoher Priorität und optisch über die rote Warn-LED und eine Meldung im Display angezeigt.

Interner-Fehler-Alarme

GEGENSTAND	BESCHREIBUNG
Definition	Ein Alarm für internen Fehler wird ausgelöst, wenn es beim Vivo 30 zu einer internen Funktionsstörung gekommen ist.
Maßnahme des Beatmungsgeräts	Das Vivo 30 beendet die Behandlung.
Anzeige	Der Alarm wird akustisch über ein Signal und optisch durch eine Meldung auf dem Display angezeigt, die für mindestens 120 s erscheint.
Rückstellen des Beatmungsgeräts	Zum Stoppen des Alarms muss das Beatmungsgerät mit dem Ein/Aus-Schalter am seitlichen Bedienfeld ausgeschaltet werden.

8 Reinigung des Vivo 30 und Austausch des Zubehörs

Die Komponenten, die mit dem Patienten verbunden sind, müssen regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion des Vivo 30 sicherzustellen. Die gebrauchten Teile müssen gemäß den regionalen Umweltbestimmungen bezüglich der Entsorgung gebrauchter Geräte und Teile entsorgt werden.

8.1 Reinigung des Vivo 30




Um einen Stromschlag zu vermeiden, unterbrechen Sie vor dem Reinigen die Spannungsversorgung Vivo 30. Tauchen Sie das Vivo 30 nicht in Flüssigkeit ein.




- Gehen Sie beim Reinigen des Geräts stets vorsichtig vor, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Es darf keine Flüssigkeit in das Vivo 30 gelangen.
- Sterilisieren Sie das Vivo 30 nicht.

Beatmungsgerät


1 Schalten Sie das Vivo 30 aus und unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.

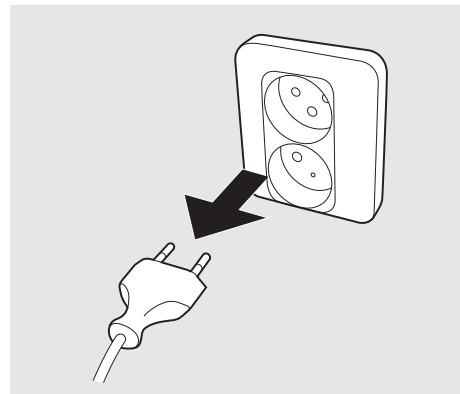

2 Entfernen Sie das Patientenschlauchsystem.

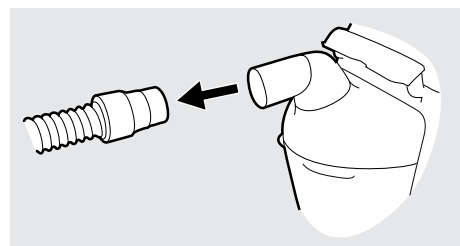


3 Bei der regelmäßigen Reinigung nach normaler Anwendung braucht die hintere Abdeckung oder die Heizeinheit des HA 20 nicht abgenommen zu werden. Lassen Sie ggf. den Luftbefeuchter HA 20 etwa 10 min abkühlen. Nehmen Sie nur den Wasserbehälter des HA 20 ab.

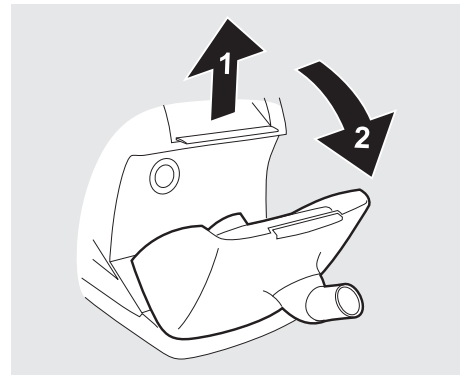


Wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist, nehmen Sie die hintere Abdeckung oder die Heizeinheit des HA 20 ab.


4 Trennen Sie alle Elektrokabel ab.

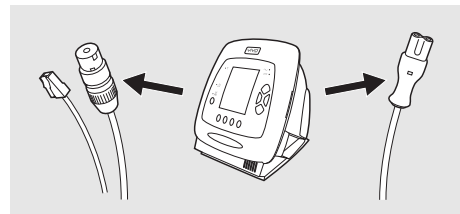

5 Reinigen Sie die Außenseite des Vivo 30 mit einem fusselfreien Tuch und milder Seifenlauge. Falls die Oberfläche des Vivo 30 desinfiziert werden muss, kann dies mit Virkon® oder Gigasept® erfolgen.

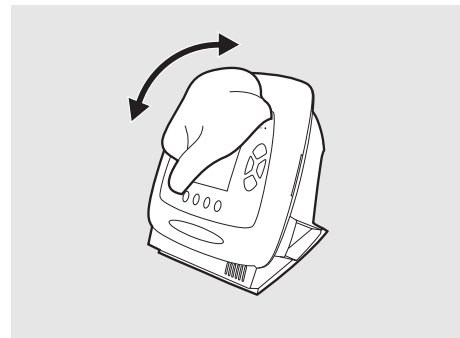

6 Schließen das Patientenschlauchsystem wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor das Vivo 30 wieder in Betrieb genommen wird.

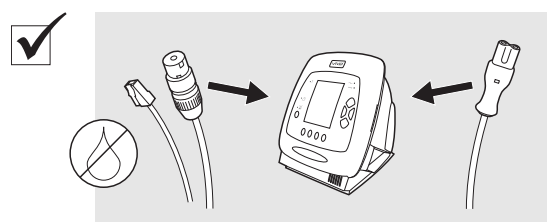

Luftbefeuchter HA 20

Der Luftbefeuchter HA 20 muss gemäß den Anweisungen des Pflegepersonals gereinigt, gewartet und ausgetauscht werden.



Weitere Informationen enthält die Gebrauchsanweisung des Breas Luftbefeuchters HA 20.

Patientenschlauchsystem



Das Patientenschlauchsystem muss stets gemäß den Anweisungen des Pflegepersonals gereinigt, desinfiziert und ausgetauscht werden.

Wenn das Vivo 30 von einem anderen Patienten verwendet werden soll, muss stets das Patientenschlauchsystem ausgetauscht werden.

Alle Teile, die mit dem Atemgas in Kontakt kommen, müssen gereinigt werden.



Wenn Sie Teile des Patientenschlauchsystems verwenden, die von Breas Medical AB empfohlen werden, sind diese wie folgt zu reinigen:

- 1 Legen Sie die abmontierten Teile in heißes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- 2 Entfernen Sie Verschmutzungen mit einer Bürste.
- 3 Spülen Sie die Teile gründlich unter fließend heißem Wasser ab.
- 4 Schütteln Sie das Wasser aus allen Teilen.
- 5 Trocknen Sie die Teile sorgfältig ab.
- 6 Lagern Sie die Teile in einer staubfreien Umgebung.

Überprüfen Sie das Patientenschlauchsystem regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen ersetzen Sie das Patientenschlauchsystem.

8.2 Reinigung und Austausch der Patienten-Luftfilter

Die Filter am Patientenlufteinlass sitzen in der Filterkassette auf der Rückseite des Beatmungsgeräts. Es gibt zwei Arten von Filtern: waschbare Filter und Einwegfilter.

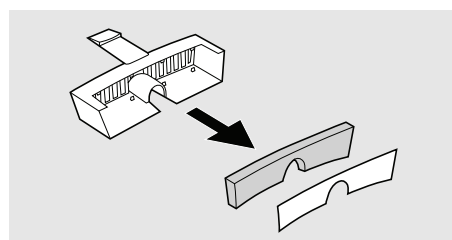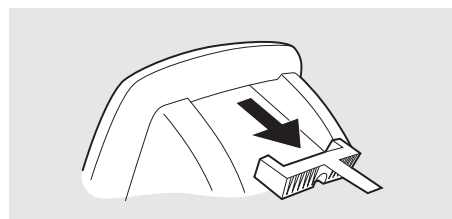

Waschbarer Filter (grau)

Erneuern Sie den Filter mindestens einmal jährlich. Waschen Sie den Filter mindestens einmal wöchentlich.

- 1** Waschen Sie den Filter mit warmem Wasser und milder Seifenlauge.
- 2** Spülen Sie ihn gründlich aus.
- 3** Trocknen Sie den Filter, indem Sie ihn in einem Handtuch ausdrücken. Der Filter darf nicht gewrungen werden.

Einwegfilter (weiß)

Erneuern Sie den Filter mindestens alle vier Wochen und bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.



Ein Einwegfilter darf weder gewaschen noch wiederverwendet werden.

8.3 Patientenwechsel

Wird das Vivo 30 in einem Krankenhaus von mehreren Patienten benutzt, muss zwischen dem Luftauslass und dem Patientenschlauch ein Bakterienfilter mit geringem Widerstand eingesetzt werden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Sollte jedoch ein Luftbefeuchter HA 20 am Vivo 30 angeschlossen sein, ist kein Bakterienfilter zu verwenden.

- 1** Befolgen Sie die Anweisungen in „Reinigung des Vivo 30“ auf Seite 47, Schritt 1 bis 5.
- 2** Bei Verwendung des HA 20 ersetzen Sie den Wasserbehälter des HA 20 und reinigen die Heizeinheit gemäß der Gebrauchsanweisung des Breas Luftbefeuchters HA 20.
- 3** Tauschen Sie die Patientenfilter gemäß „Reinigung und Austausch der Patienten-Luftfilter“ auf Seite 49 aus.
- 4** Falls ein Bakterienfilter benutzt wird, muss dieser ausgewechselt werden. Wurde kein Bakterienfilter mit geringem Widerstand verwendet muss das Gerät vor dem Wiedereinsatz an die Breas Medical GmbH oder Ihren Fachhändler (auf Anfrage) zur weiteren hygienischen Aufbereitung eingeschickt werden.
- 5** Nehmen Sie ein neues Patientenschlauchsystem, wenn das Vivo 30 von einem neuen Patienten benutzt wird.

9 Wartung



WARNUNG!

- **Wartung, Service und Kontrolle sowie Aktualisierungen des Vivo 30 müssen gemäß den Serviceanweisungen von Breas erfolgen.**
- **Das Vivo 30 darf nur gemäß dem Breas-Servicehandbuch, den technischen Blättern und den speziellen Serviceanweisungen von Servicepersonal repariert und/oder modifiziert werden, die nach Breas-Vivo 30-Serviceschulung dazu befugt sind, oder die über ein entsprechendes technisches Know-how im Hinblick auf medizinische Geräte verfügen.**
- **Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Vivo 30 selbst zu reparieren. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Leistung und Sicherheit des Vivo 30.**

ABWEICHUNGEN VON DIESEN SERVICEANWEISUNGEN KÖNNEN ZU KÖRPERLICHEN SCHÄDEN FÜHREN!

9.1 Regelmäßige Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsinspektionen und -kontrollen müssen alle 12 Monate ausgeführt werden. Wartungsarbeiten gemäß Anweisungen im Servicehandbuch des Vivo 30.



Verwenden Sie das Gerät nicht und setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst zwecks Inspektion in Verbindung:

- **falls unerwartete Patientensymptome während der Behandlung auftreten,**
- **falls unerklärliche oder plötzliche Druck-, Leistungs- oder Geräuschabweichungen während des Betriebs auftreten sowie**
- **falls eine Beschädigung des Geräts vermutet wird.**

9.2 Service und Reparatur

Service und Reparatur des Vivo 30 müssen von dazu befugtem Servicepersonal gemäß den Serviceanweisungen von Breas vorgenommen werden. Die Serviceinspektionen müssen stets nach Reparaturarbeiten am Gerät durchgeführt werden.



Autorisierte Service-Werkstätten können das Servicehandbuch des Vivo 30 bestellen, in dem die erforderliche technische Dokumentation für die Wartung und den Service des Vivo 30 enthalten ist.

9.3 Aufbewahrung


Leeren, reinigen und trocknen Sie den Luftbefeuchter HA 20 (falls vorhanden), bevor Sie das Vivo 30 aufbewahren.

9.4 Entsorgung

Das Vivo 30, sämtliches Zubehör und alle ausgetauschten Teile müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltrichtlinien im Hinblick auf die Entsorgung und das Recycling von gebrauchten Ausrüstungskomponenten und Abfällen entsorgt werden.



Mit dem Vivo 30 verwendete Batterien müssen gemäß den örtlichen Umweltbestimmungen wiederverwertet werden.



10 Technische Daten

10.1 Daten



Das Vivo 30 und seine Verpackung enthalten kein Naturlatex.

EINSTELLUNG/ WERT	EINSTELLUNGSBEREICH/LEI- STUNG	AUFLÖSUNG
Beatmungsmodi	<ul style="list-style-type: none">• PSV (Pressure Support Ventilation)• PCV (Pressure Control Ventilation)• CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)	
Gerätemodi	<ul style="list-style-type: none">• Klinik• Heim	
EPAP	2 bis 20 hPa (mbar) oder IPAP -2 hPa (mbar) Toleranz: ± 2 % des maxi- malen Werts und ± 10 % des eingestellten Werts	0,5 unter 10 hPa (mbar) 1,0 über 10 hPa (mbar)
IPAP	4 bis 30 (hPa) mbar Toleranz: ± 2 % des maxi- malen Werts und ± 10 % des eingestellten Werts	0,5 unter 10 hPa (mbar) 1,0 über 10 hPa (mbar)
CPAP	4 bis 20 hPa (mbar) Toleranz: ± 2 % des maxi- malen Werts und ± 10 % des eingestellten Werts	0,5 hPa (mbar)
Frequenz	4 bis 40 Atemzüge pro Minute (bpm), Toleranz: ± 10 % des eingestellten Werts	1 bpm
Inspirationszeit	0,3 bis 5 s, Toleranz: ± 10 % des eingestellten Werts	0,1 s

EINSTELLUNG/ WERT	EINSTELLUNGSBEREICH/LEI- STUNG	AUFLÖSUNG
Min.- Inspirationszeit	Aus, 0,3 bis 3 s	0,1 s
Max.- Inspirationszeit	0,3 bis 3 s, Aus	0,1 s
Anstieg	1 bis 9	1
Inspirations- trigger Kraftauf- wand	1 bis 9, Aus	1
Expirations- trigger Kraftauf- wand	1 bis 9, wobei 1 die Einstell- ung für den geringsten Kraft- aufwand ist und 9 für den höchsten	1
Rampe	Ein, Aus, Inaktiv	
Luftbefeuchter HA 20	Einstellungen: Aus, 1 bis 9, 1 entspricht 10 bis 30 mgH ₂ O/l, <100 % RH. Aufwärmdauer ab 23 °C: weniger als 1 h. Max. Gastemperatur am Pati- entenausgang: 43 °C.	1
Lautstärke (aku- stischer Alarm)	1 bis 9, wobei 1 die Einstell- ung für die geringste Laut- stärke ist und 9 für die höchste	1
Maximaler Flow	> 200 l/min	
Maximaler, ein- geschränkter Druck bei Single- Fault-Bedingung	PCV, PSV: 60 hPa (mbar) CPAP: 30 hPa (mbar)	
Maximaler kon- stanter Grenz- druck	Gesetzter IPAP + 10 hPa (mbar), Toleranz: ±10%	

EINSTELLUNG/ WERT	EINSTELLUNGSBEREICH/LEI- STUNG	AUFLÖSUNG
Max. Luftstrom im CPAP-Modus	1/3 des maximalen Drucks: 110 l/min 2/3 des maximalen Drucks: 150 l/min Max.-Druck: 155 l/min	
Atmungswider- stand unter Sin- gle-Fault- Bedingungen	4 hPa (mbar) bei 30 l/min 6 hPa (mbar) bei 60 l/min	
Geräuschpegel bei 10 hPa (mbar)	Unter 30 dB(A)	Gemessen in 1 m Entfernung

ANZEIGE	EINSTELLUNGSBEREICH/ SPEZIFIKATION	AUFLÖSUNG
Druck	0 bis 30 hPa (mbar)	±2 % der Skalenvollaus- schlags- und ±4 % des tatsächlichen Werts
Kalk. Volumen	0 bis 9,99 l (BTPS, Body Temperature and Pressure Saturated)	Bei Normalnull: ±20 % oder ±20 ml, je nachdem, welcher Wert größer ist
Leckage	0 bis 99,9 l/min (BTPS)	1 l/min, ±20 %
Akt. Frequenz	0 bis 60 bpm (Atem pro Minute)	1
I:E	1:10 bis 10:1	0,1 Einheit, ±1 Einheit

ALARM	SPEZIFIKATION	ANZEIGE
Akustischer Alarmton	35 bis 85 dB(A)	±5 dB(A) Gemessen in 1 m Entfernung

ALARM	SPEZIFIKATION	ANZEIGE
Druck-Tief-Alarm	2 hPa (mbar) bis IPAP Auflösung 1 hPa (mbar)	Rote LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Druck-Hoch-Alarm	Selbstregulierend	Rote LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Volumen-Tief-Alarm	Aus, 0,03 bis 2,0 l Auflösung 0,05 l	Rote LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display. Präzision: 0,05 l
Leckage-Tief-Alarm	Ein/Aus	Gelbe LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Leckage-Hoch-Alarm	Selbstregulierend	Rote LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Warnung für Externe Batterie-Tief	Ext. DC 12 V: 11.3 V Ext. DC 24 V: 22.7 V	Gelbe LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Spannung-Tief-Alarm	Netzspannung: 65 ±15 V AC Ext. DC 12 V: 10,0 ±0,5 V Ext. DC 24 V: 20,0 ±0,5 V	Rote LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.
Interner-Fehler-Alarme		Rote oder gelbe LED, akustischer Alarm und eine Warnmeldung auf dem Display.

SPANNUNGSVERSORGUNG	SPEZIFIKATION
Netzanschluss	100 bis 240 V AC, Toleranz: +10 %/–20 %, 50 bis 60 Hz, max. 140 VA
Externe Batterie	12/24 V DC, Toleranz: +20 %/–15 % (10,5 bis 15 V/20,4 bis 30 V) Max. 120 W mit externer Breas-Batterie

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	SPEZIFIKATION
Betriebstemperaturbereich	5 bis 38 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 bis +60 °C
Umgebungsluftdruck	600 bis 1060 mbar, entspricht ~4000 m über Normalnull bis ~375 m unter Normalnull, bei normalem Atmosphärendruck
Feuchte	10 bis 95 %, nicht kondensierend

BETRIEBSBEDINGUNGEN	SPEZIFIKATION
Empfohlene Leckage	20 bis 40 l/min bei 10 hPa (mbar)
Minimale Leckage	12 l/min bei 4 hPa (mbar)

ABMESSUNGEN	SPEZIFIKATION
B × H × T	190 × 225 × 223 mm (mit hinterer Abdeckung)
Gewicht	3,1 kg (mit hinterer Abdeckung)
Luftauslass	22 mm konischer Standardanschluss

11 Zubehör

11.1 Breas-Zubehörliste



Verwenden Sie nur das von Breas Medical AB empfohlene Zubehör. Breas Medical AB übernimmt keine Garantie im Hinblick auf Leistung und Sicherheit, wenn das Vivo 30 zusammen mit anderem Zubehör verwendet wird.

Folgendes Breas-Zubehör ist zurzeit für das Vivo 30 erhältlich:

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Tragetasche	003519
Gebrauchsanweisung	003824
Patientenschlauch	000245
Luftbefeuchter HA 20 (Heizeinheit + Wasserbehälter)	2230 XX
Wasserbehälter für HA 20	004861
Hintere Abdeckung	003591
Filter (grau, waschbar)	003563 (5 St.)
Filter (weiß, Einweg)	003564 (5 St.)
Bakterienfilter mit geringem Widerstand (303 Respirgard-II-Filter)	004185
Netzkabel (Vivo)	003520
Externes DC-Kabel (EB 2)	003584
Externes EB 2 Batteriepaket 24 V DC, einschließ- lich Kabel, Ladegerät und Tasche	004127



Die Zubehörteile, die an die analogen und digitalen Schnittstellen angeschlossen werden, müssen den Richtlinien der IEC-Standards entsprechen (z. B. IEC 60950 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik und IEC 60601-1 Sicherheit medizinischer elektrischer Geräte). Außerdem müssen alle Konfigurationen der gültigen Version des Systemstandards IEC 60601-1-1 entsprechen. Jeder, der zusätzliche Komponenten an eine Signaleingangs- oder -ausgangsschnittstelle anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist somit verantwortlich dafür, dass das System den Anforderungen der gültigen Version des Systemstandards IEC 60601-1-1 entspricht. Bei Fragen wenden Sie sich an den technischen Service oder an Ihre Breas-Regionalvertretung.

12 Patienteneinstellungen

Patienteneinstellungen – Breas Vivo 30

Patient

Datum

Klinik

Eingestellt von

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCV	PSV	CPAP

IPAP Max.-Inspirationszeit

EPAP Min.-Inspirationszeit

Frequenz Inspirationszeit

Anstieg Inspirationstrigger

CPAP Expirationstrigger

Rampe

Luftbefeuchter

Anmerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

